



徐州市检验检测中心

Xuzhou Inspection Testing Center

检定证书

Verification Certificate

证书编号:
Certificate No.



24YL818322349

送检单位
Applicant 徐州市肿瘤医院

计量器具名称
Instrument 数字心电图机

型号规格
Type MECG-300

出厂编号
Serial No. 011421-3病区

制造单位
Manufacture 北京麦迪克斯科技有限公司

检定结论
Conclusion 合格



批准人
Approver

陈曦

陈曦

核验员
Inspector

张峰硕

张峰硕

检定员
Operator

张宇昕

张宇昕

检定日期
Issued date

2024 年 07 月 31 日
Year Month Day

有效期至
Valid date to

2025 年 07 月 30 日
Year Month Day

计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2024)10062号
地址(Addr): 江苏省徐州市云龙区商聚路12号
网址(Web Site): <http://www.xzzjs.com>

电话/传真(Tel/Fax): 0516-85601413
邮编(Post Code): 221018
Email: xuzhouzhijian@163.com





证书编号:
Certificate No.



24YL818322349

本中心是国家法定计量检定机构，计量授权证书号：(苏)法计(2024)10062号。

This laboratory is national legal metrological verification institute. Authorization certificate No. (2024) 10062.

本次校准所使用的计量标准器具的量值溯源至国家计量基准/测量标准。

The value of the standards measuring instruments used in the calibration is traceable to the national standards/measurement standard.

技术依据/参照的技术文件

Reference document for the Verification

JJG 1041-2008《数字心电图机检定规程》

本次检定使用的计量标准

Measurement Standards used in this Verification

名称	测量范围	准确度等级/最大允许误差/不确定度	标准证书编号	有效期至
心电图机检定装置	电压：50 μ V~30V， 频率：(0.1~200)Hz	电压： $\pm 1.0\%$ 频率： $\pm 0.5\%$	[1994]省量标徐法 证字第002号	2027-04-19

主要计量仪器

Main Equipment of Measurement used in the Verification

仪器名称	型号规格	准确度等级/最大允许误差/不确定度	溯源机构名称	证书编号/有效期
智能心脑电图机心电图监护仪检定仪	ECG-3	电压： $\pm 1\%$ ；频率： $\pm 0.5\%$	江苏省计量科学研究院	E2024-0072566 2025-07-15

检定地点和环境条件

Environmental Condition on the Verification

地点：徐州市肿瘤医院

温度：23.9 $^{\circ}$ C

湿度：45.1 %RH

其它：/

说明：本证书的结果仅对本次检定仪器有效；

Note: The results are only responsible for the items verified.

本证书未加盖本中心专用章无效；

This certificate will be invalid without official stamp.

未经本中心书面授权，不得部分复制本证书。

This certificate shall not be copied partly without the written approval of the laboratory.

证书编号:



Certificate No. 24YL818322349

检定结果:

Verification Results

序号	检定项目	检定结果	
1	外观和工作正常性	合格	
2	内定标电压误差(%)	0%	合格
3	输入电压范围	合格	
4	耐极化电压	合格	
5	加权系数误差(%)	0%	合格
6	内部噪声电平	合格	
7	波形识别能力	合格	
8	幅度测量误差(%)	-7.0%	合格
9	时间间隔测量误差(%)	6.2%	合格
10	心率测量误差(次/分)	0	合格

以下无数据内容





徐州市检验检测中心

Xuzhou Inspection Testing Center

检定证书

Verification Certificate

证书编号:
Certificate No.



24YL818322348

送检单位
Applicant 徐州市肿瘤医院

计量器具名称
Instrument 数字心电图机

型号规格
Type MECG-200

出厂编号
Serial No. C201501067-心电图室

制造单位
Manufacture 迈迪克斯

检定结论
Conclusion 合格



批准人
Approver

陈曦

陈曦

核验员
Inspector

张峰硕

张峰硕

检定员
Operator

张宇昕

张宇昕



检定日期
Issued date

2024

年
Year

07

月
Month

31

日
Day

有效期至
Valid date to

2025

年
Year

07

月
Month

30

日
Day

计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2024)10062号
地址(Addr): 江苏省徐州市云龙区商聚路12号
网址(Web Site): <http://www.xzzjs.com>

电话/传真(Tel/Fax): 0516-85601413
邮编(Post Code): 221018
Email: xuzhouzhijian@163.com



证书编号:

Certificate No. 24YL818322348



本中心是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏)法计(2024)10062号。

This laboratory is national legal metrological verification institute. Authorization certificate No. (2024) 10062.

本次校准所使用的计量标准器具的量值溯源至国家计量基准/测量标准。

The value of the standards measuring instruments used in the calibration is traceable to the national standards/measurement standard.

技术依据/参照的技术文件

Reference document for the Verification

JJG 1041-2008《数字心电图机检定规程》

本次检定使用的计量标准

Measurement Standards used in this Verification

名称	测量范围	准确度等级/最大允许误差/不确定度	标准证书编号	有效期至
心电图机检定装置	电压: 50 μ V~30V, 频率: (0.1~200)Hz	电压: $\pm 1.0\%$ 频率: $\pm 0.5\%$	[1994]省量标徐法 证字第002号	2027-04-19

主要计量仪器

Main Equipment of Measurement used in the Verification

仪器名称	型号规格	准确度等级/最大允许误差/不确定度	溯源机构名称	证书编号/有效期
智能心脑电图机心电 监护仪检定仪	ECG-3	电压: $\pm 1\%$;频率: $\pm 0.5\%$	江苏省计量科学研 究院	E2024-0072566 2025-07-15

检定地点和环境条件

Environmental Condition on the Verification

地点: 徐州市肿瘤医院

温度: 23.9 $^{\circ}$ C

湿度: 45.1 %RH

其它: /

说明: 本证书的结果仅对本次检定仪器有效;

Note: The results are only responsible for the items verified.

本证书未加盖本中心专用章无效;

This certificate will be invalid without official stamp.

未经本中心书面授权, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be copied partly without the written approval of the laboratory.



证书编号:



Certificate No. 24YL818322348

检定结果:

Verification Results

序号	检定项目	检定结果	
1	外观和工作正常性	合格	
2	内定标电压误差(%)	0%	合格
3	输入电压范围	合格	
4	耐极化电压	合格	
5	加权系数误差(%)	0%	合格
6	内部噪声电平	合格	
7	波形识别能力	合格	
8	幅度测量误差(%)	-4.6%	合格
9	时间间隔测量误差(%)	4.5%	合格
10	心率测量误差(次/分)	0	合格

以下无数据内容





徐州市检验检测中心

Xuzhou Inspection Testing Center

检定证书

Verification Certificate

证书编号:
Certificate No.



24YL818322347

送检单位
Applicant 徐州市肿瘤医院

计量器具名称
Instrument 数字心电图机

型号规格
Type MECG-200

出厂编号
Serial No. C201401383-心电图室

制造单位
Manufacture 迈迪克斯

检定结论
Conclusion 合格



批准人
Approver

陈曦

陈曦

核验员
Inspector


张峰硕

张峰硕

检定员
Operator

张宇昕

张宇昕

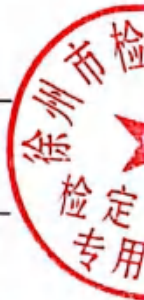

检定日期
Issued date

2024

年

07

月

31

日

有效期至
Valid date to

2025

年

07

月

30

日

计量检定机构授权证书号: (苏)法计(2024)10062号
地址(Addr): 江苏省徐州市云龙区商聚路12号
网址(Web Site): <http://www.xzzjs.com>

电话/传真(Tel/Fax): 0516-85601413
邮编(Post Code): 221018
Email: xuzhouzhijian@163.com



证书编号:

Certificate No.

24YL818322347

本中心是国家法定计量检定机构, 计量授权证书号: (苏) 法计 (2024) 10062号。

This laboratory is national legal metrological verification institute. Authorization certificate No. (2024) 10062.

本次校准所使用的计量标准器具的量值溯源至国家计量基准/测量标准。

The value of the standards measuring instruments used in the calibration is traceable to the national standards/measurement standard.

技术依据/参照的技术文件

Reference document for the Verification

JJG 1041-2008《数字心电图机检定规程》

本次检定使用的计量标准

Measurement Standards used in this Verification

名称	测量范围	准确度等级/最大允许误差/不确定度	标准证书编号	有效期至
心电图机检定装置	电压: 50 μ V~30V, 频率: (0.1~200)Hz	电压: $\pm 1.0\%$ 频率: $\pm 0.5\%$	[1994]省量标徐法 证字第002号	2027-04-19

主要计量仪器

Main Equipment of Measurement used in the Verification

仪器名称	型号规格	准确度等级/最大允许误差/不确定度	溯源机构名称	证书编号/有效期
智能心脑电图机心电图监护仪检定仪	ECG-3	电压: $\pm 1\%$;频率: $\pm 0.5\%$	江苏省计量科学研究院	E2024-0072566 2025-07-15

检定地点和环境条件

Environmental Condition on the Verification

地点: 徐州市肿瘤医院

温度: 23.9 $^{\circ}$ C

湿度: 45.1 %RH

其它: /

说明: 本证书的结果仅对本次检定仪器有效;

Note: The results are only responsible for the items verified.

本证书未加盖本中心专用章无效;

This certificate will be invalid without official stamp.

未经本中心书面授权, 不得部分复制本证书。

This certificate shall not be copied partly without the written approval of the laboratory.

证书编号: 
Certificate No. 24YL818322347

检定结果:
Verification Results

序号	检定项目	检定结果	
1	外观和工作正常性	合格	
2	内定标电压误差 (%)	-2%	合格
3	输入电压范围	合格	
4	耐极化电压	合格	
5	加权系数误差 (%)	-2%	合格
6	内部噪声电平	合格	
7	波形识别能力	合格	
8	幅度测量误差 (%)	6.0%	合格
9	时间间隔测量误差 (%)	-6.3%	合格
10	心率测量误差 (次/分)	0	合格

以下无数据内容

